



Warszawa, dnia 12 maja 2017 r.

WSPRiTS/ZP/M4/2017
ZP.261.13.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 501605-N-2017 z dnia 05.05.2017 r. na okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/13/17].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 1 „Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Nonin”

1) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

2) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który posiada uprawnienia do wykonywania przeglądów w przedmiotowej aparaturze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz certyfikatami ze szkoleń dot. świadczenia usług serwisowych wyznaczonej aparatury medycznej, odbytych u niezależnej niemieckiej firmy specjalizującej się w tego typu szkoleniach? W ustawie Prawo Zamówień publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Zamawiający stawiając wymóg autoryzacji odrzuca Wykonawców, którzy posiadają prawo do wykonywania czynności serwisowych i naprawczych aparatury medycznej. Cechują się wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, posiadają wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, rozbudowane i silne zaplecze logistyczne, techniczne i administracyjne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie narzuca obowiązku dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich działających na rynku podmiotów.

Dotyczy Zadania 2 „Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Ascor”

3) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009



Dotyczy Zadania 3 „Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medima”

4) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

5) PYTANIE: Czy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany akumulatorów?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności sprawdzających, konserwacyjnych i serwisowych przewidzianych przez producenta dla danego urządzenia.

Dotyczy Zadania 4 „Serwis i naprawa platformy Auto-Pulse firmy Zoll”

6) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

7) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który posiada uprawnienia do wykonywania przeglądów w przedmiotowej aparaturze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz certyfikatami ze szkoleń dot. świadczenia usług serwisowych wyznaczonej aparatury medycznej, odbytych u niezależnej niemieckiej firmy specjalizującej się w tego typu szkoleniach? W ustawie Prawo Zamówień publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Zamawiający stawiając wymóg autoryzacji odrzuca Wykonawców, którzy posiadają prawo do wykonywania czynności serwisowych i naprawczych aparatury medycznej. Cechują się wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, posiadają wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, rozbudowane i silne zaplecze logistyczne, techniczne i administracyjne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie narzuca obowiązku dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich działających na rynku podmiotów.

Dotyczy Zadania 5 „Serwis i naprawa sprzętu medycznego Boscarol, Ferno, Smiths, Zoll”

8) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

9) PYTANIE: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ramach przeglądów respiratorów mają być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeciągu 4 lat?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonywał przeglądów zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

10) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który posiada uprawnienia do wykonywania przeglądów w przedmiotowej aparaturze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz certyfikatami ze szkoleń dot. świadczenia usług serwisowych wyznaczonej aparatury medycznej, odbytych u niezależnej niemieckiej firmy specjalizującej się w tego typu szkoleniach? W ustawie Prawo Zamówień publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Zamawiający stawiając wymóg autoryzacji odrzuca Wykonawców, którzy posiadają prawo do wykonywania czynności serwisowych i naprawczych aparatury medycznej. Cechują się wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, posiadają wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, rozbudowane i silne zaplecze logistyczne, techniczne i administracyjne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie narzuca obowiązku dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich działających na rynku podmiotów.

Dotyczy Zadania 7 „Serwis i naprawa sprzętu medycznego firmy Medtronic”

11) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

Dotyczy Zadania 9 „Serwis i naprawa respiratora CARE VENT”

12) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

13) PYTANIE: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ramach przeglądów respiratorów mają być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeciągu 4 lat?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonywał przeglądów zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

Dotyczy Zadania 15 „Serwis i naprawa kapnometrów Emma”

14) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

Dotyczy Zadania 16 „Serwis i naprawa respiratora firmy WEINMANN”

15) PYTANIE: Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonał przeglądu zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

16) PYTANIE: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ramach przeglądów respiratorów mają być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeciągu 4 lat?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dokonywał przeglądów zgodnie z zapisem SIWZ. Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego. Zamawiający nie wymaga zawarcia ceny części koniecznej do wymiany w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, bądź cech uniemożliwiających dalsze użytkowanie.

17) PYTANIE: Zgodnie z wymogami producenta Weinmann Emergency Medical Technology GmbH+ Co.KG, wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne wykonywać może jedynie autoryzowany serwis oraz upoważnieni do tego przez producenta serwisanci. W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wymóg w zakresie w/w zadania od Wykonawców przedstawienia autoryzacji serwisowej wystawionej przez producenta Weinmann.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga autoryzacji.

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy

18) PYTANIE: Rozdział II pkt. 4 SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oświadczenia o grupie kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp drogą elektroniczną lub faksem, natomiast oryginał pocztą?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, to Zamawiający uzna wymogi ustawowe w tym zakresie za spełnione.

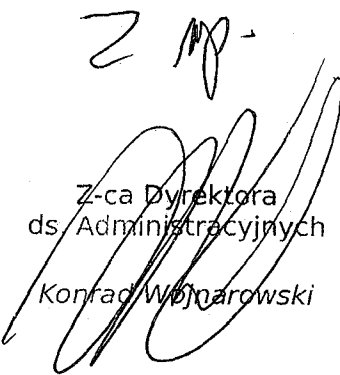
19) PYTANIE: Rozdział II pkt. 5 SIWZ Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o rezygnację z zapisu w pkt. 5 rozdziału II SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

20) PYTANIE: § 2 ust. 5 W umowie zamawiający w §2 ust. 5 zawarł zapis: „Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cenami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji. Zamawiający nie wymaga wliczenia w cenę przeglądu części zamiennych – również w tych wymagających cyklicznej wymiany. Informacja o dokonanej zmianie części zamiennych będzie przedstawiona każdorazowo Wykonawcy wraz z urządzeniem w dokumentacji technicznej”. Czy zgodnie z tym zapisem, pakiet serwisowy, wymieniany każdorazowo przy przeglądzie co 2 lata, zgodnie z zaleceniami producenta respiratora Medumat, firmy Weinmann Emergency Medical Technology GmbH+ Co.KG, zostanie rozliczony osobną ofertą? Wymiana zestawów przeglądowych jest niezbędnym warunkiem, aby urządzenia zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wymiana części zamiennych, w tym również wymagających cyklicznej wymiany, zostanie rozliczona osobną ofertą.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Konrad Wojnarowski